
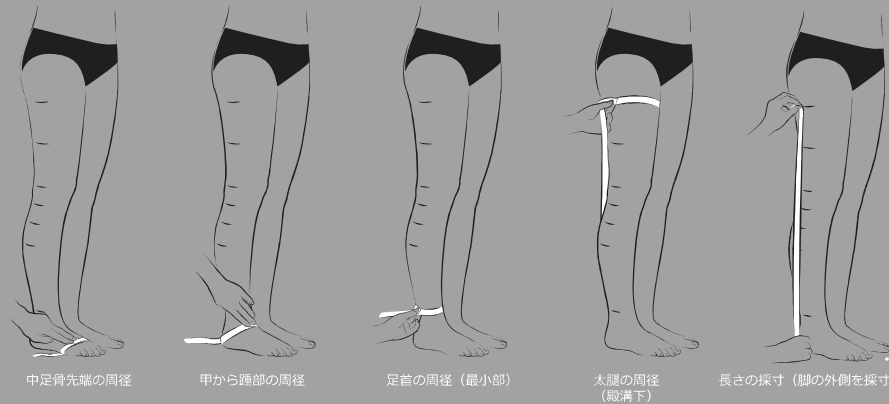


# MEASURING FOR

## モビダーム・ストッキング／ソックスの採寸

採寸部の印は、脚の外側に付けてください

### 採寸場所

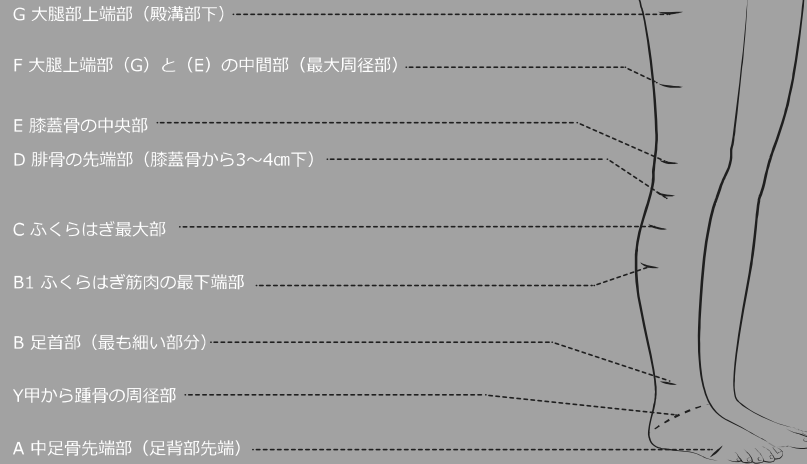

ソックス：cAからcDの周径と床からIDの長さ  
ストッキング：cAからcGの周径と床からIGの長さ



**THUASNE** 日付(Date): .....

患者名(ローマ字):.....

性別(Gender): ☐ 男(M) ☐ 女(F) ☐ 小兒(Child)

住所(Address): 〒.....

電話(Phone):.....

担当者名(Prescriber's name): .....

施設名/取扱店名

JAPAN

### 採寸方法

計測ポイントにメジャーを密着させ、実寸値にて測定します。

※採寸時は立位で測ります。

※患肢の形状が変形している場合には、画像を添付してください。

### 形状 (Models)

☐ ハイソックス (Sock)☐ ストッキング (Stocking)

左 (Left)

右 (Right)

☐☐

### 追加オプション (Options)

☐ ベルクロ加工 (最大の長さは製品丈の1/3まで) (Velcro opening)

※ベルクロ加工は追加料金が発生します

※ベルクロ加工選択の場合は、スリップベルトは付きません

☐つま先なし (Open toe)

☐つま先あり (Closed toe)

### ブロックオプション (Foam option)


□ 5mm ブロック (All small blocks)

☐ 15mm ブロック (All big blocks)

□15mm ブロック+足背 5mm ブロック

(Big blocks on the leg and small blocks on the feet)

コメント (Comments)

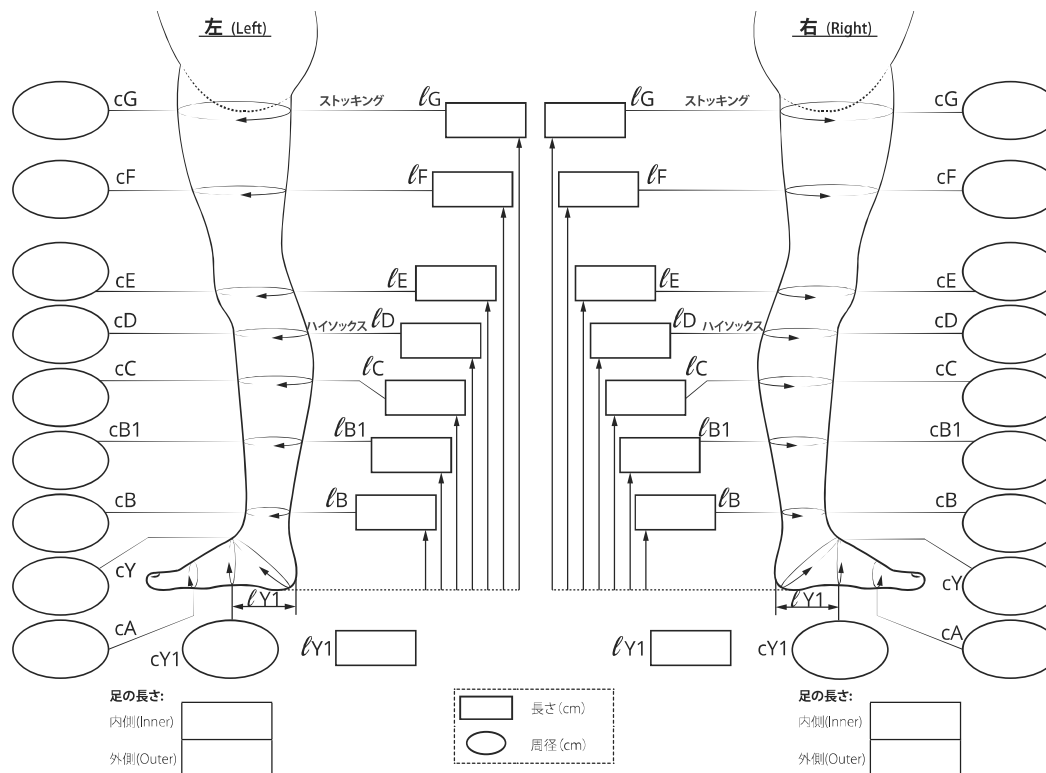

ソルブ株式会社 FAX: 045-772-8201 へお送りください。